



**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA,
PER LA REALIZZAZIONE, "CHIAVI IN MANO",
DI N. 1 SALA OPERATORIA IBRIDA MULTIDISCIPLINARE
PER L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA**

CIG: 9349832D70

CUP: G49J21015660002

CUP: G92C22000350002

VERBALE n. 1 Commissione giudicatrice

L'anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di novembre, alle ore 14.00, presso l'aula riunioni della S.C. Anestesia e Rianimazione TIPO in Trieste, Strada di Fiume, n. 447, e tramite la piattaforma Lifesize la Dott.ssa Colella, si è riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnico-qualitativa relativa alla procedura aperta per la realizzazione "chiavi in mano" di n. 1 sala operatoria ibrida multidisciplinare per l'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore generale n. 956 del 9 novembre 2022, è composta da:

- Prof. Sandro Lepidi - Direttore della S.C. Clinica di Chirurgia Vascolare – Presidente della Commissione;
- Dott. Fabio Pozzi Mucelli - Dirigente Medico presso la S.C. Radiologia Diagnostica ed Interventistica;
- Dott.ssa Paola Bregant - Dirigente Fisico presso la S.C. Fisica Sanitaria;
- Ing. Francesco Barbagli - Dirigente Ingegnere presso la S.C. Ingegneria Clinica;
- Dott.ssa Elisa Colella – Responsabile Infermieristico del Complesso Operatorio Cattinara – Blocco 1.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Francesca Vignandel. E' presente anche la nominata supplente Dott.ssa Stefania Bearzi.

Si dà atto del collegamento da remoto del rappresentante della ditta GE MEDICAL SYSTEM SRL delegato ad assistere alla seduta, debitamente identificato tramite documentazione agli atti.

Premesso che:

- la gara in argomento è svolta in modalità telematica attraverso l'utilizzo del portale eAppaltiFVG;

- la procedura è articolata in un unico lotto;

- con Decreto del Direttore Generale n. 956 del 9 novembre 2022 si è provveduto ad ammettere alla fase di apertura della busta tecnica i seguenti Operatori Economici:

- Costituendo RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. C.F. 93027710016 P. I.V.A. 03663500969 (Capogruppo Mandataria) e MORVIDUCCI S.r.l. C.F./P.IVA 05690581003 (Mandante);
- Costituendo RTI PHILIPS S.p.A. C.F./P.IVA 00856750153 (Capogruppo Mandataria) e C.R.S. IMPIANTI S.r.l. C.F./P.IVA 03398270169 (Mandante);
- Costituendo RTI SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. C.F. 04785851009 P.IVA 12268050155 (Capogruppo Mandataria) e S.M. SERVICE S.r.l. C.F./P.IVA 03502110277.

- L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto **qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Disciplinare di Gara, con i punteggi massimi di seguito indicati:

- PUNTEGGIO MASSIMO	-	70	-	30	-	100
	-	Offerta Tecnica	-	Offerta Economica	-	TOTALE

- nella valutazione dell'offerta tecnica si terrà conto della "Tabella criteri di valutazione rettificata", allegata e parte integrante e sostanziale della determinazione n. 1186 del 12 ottobre 2022 di rettifica del Disciplinare di Gara per mero errore materiale;

- si procederà alla riparametrazione dei punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle proposte oggetto di esame da parte della Commissione dovesse aver conseguito, a seguito dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di punti 70.

LA COMMISSIONE PROCEDE QUINDI:

- all'apertura delle buste tecniche e alla verifica della corrispondenza della documentazione caricata dagli operatori economici sopra indicati rispetto a quanto previsto nel Disciplinare di Gara, all'art. 15;

- al download massivo della documentazione presente nella busta tecnica presentata dagli stessi operatori economici.

La Commissione Giudicatrice prende atto che la ditta Philips S.p.a. ha caricato nella busta tecnica l'Allegato 1 "Questionario" di cui all'art. 15 del Disciplinare di Gara, solo in formato Excel, non anche in formato pdf, ma rilevato che il documento caricato consente la ricerca all'interno del testo ed è firmato digitalmente e quindi non modificabile, risulta conforme.

La Commissione decide di procedere alla valutazione nel merito della documentazione tecnica in seduta riservata.

La seduta pubblica si conclude alle ore 14.35.

Letto, approvato, sottoscritto.

Prof. Sandro Lepidi

Dott. Fabio Pozzi Mucelli

Dott.ssa Paola Bregant

Ing. Francesco Barbagli

Dott.ssa Elisa Colella

Dott.ssa Francesca Vignandel

Dott.ssa Stefania Bearzi

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA,

PER LA REALIZZAZIONE, "CHIAVI IN MANO",

DI N. 1 SALA OPERATORIA IBRIDA MULTIDISCIPLINARE

PER L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

CIG: 9349832D70

CUP: G49J21015660002

CUP: G92C22000350002

VERBALE n. 2 Commissione giudicatrice

L'anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di novembre, alle ore 14.40, presso l'aula riunioni della S.C. Anestesia e Rianimazione TIPO, in Trieste, Strada di Fiume, n. 447, e tramite piattaforma Lifesize la Dott.ssa Colella, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnico-qualitativa relativa alla procedura aperta per la realizzazione "chiavi in mano" di n. 1 sala operatoria ibrida multidisciplinare per l'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Francesca Vignandel. E' presente anche la nominata supplente Dott.ssa Stefania Bearzi.

La Commissione Giudicatrice, nella seduta pubblica di data odierna aveva verificato positivamente che gli operatori economici partecipanti avessero caricato nelle buste tecniche i documenti richiesti dal Disciplinare di Gara, all'art. 15, e che gli stessi fossero sottoscritti digitalmente, come richiesto. Veniva effettuato il download massivo della documentazione caricata nelle buste tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti:

- Costituendo RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. C.F. 93027710016 P. I.V.A. 03663500969 (Capogruppo Mandataria) e MORVIDUCCI S.r.l. C.F./P.IVA 05690581003 (Mandante);

- Costituendo RTI PHILIPS S.p.A. C.F./P.IVA 00856750153 (Capogruppo Mandataria) e C.R.S. IMPIANTI S.r.l. C.F./P.IVA 03398270169 (Mandante);

- Costituendo RTI SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. C.F. 04785851009 P.IVA 12268050155 (Capogruppo Mandataria) e S.M. SERVICE S.r.l. C.F./P.IVA 03502110277.



La Commissione Giudicatrice, nella seduta riservata odierna, procede quindi a una prima analisi del contenuto della documentazione presentata riscontrandone la conformità con la *lex specialis* di gara.

Il presidente incarica, quindi, il segretario verbalizzante di richiedere agli operatori economici, tramite la messaggistica della piattaforma eAppaltiVG, la visione delle apparecchiature proposte al fine di organizzare la prova pratica, così come previsto dall'art. 13 del Capitolato Speciale.


La seduta riservata si conclude alle ore 16.15 e viene riconvocata per il giorno 15.12.2022, ad ore 11.30.

Letto, approvato, sottoscritto.


Prof. Sandro Lepidi



Dott. Fabio Pozzi Mucelli




Dott.ssa Paola Bregant




Ing. Francesco Barbagli




Dott.ssa Elisa Colella



Dott.ssa Francesca Vignandel



Dott.ssa Stefania Bearzi





**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA,
PER LA REALIZZAZIONE, "CHIAVI IN MANO",
DI N. 1 SALA OPERATORIA IBRIDA MULTIDISCIPLINARE
PER L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA**

CIG: 9349832D70
CUP: G49J2101566002
CUP: G92C22000350002

VERBALE N. 3 Commissione Giudicatrice

L'anno duemilaventidue, il giorno 15 del mese di dicembre, alle ore 11.30, presso la sala riunioni della S.C. Anestesia e Rianimazione TIPO dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in Trieste, Strada di Fiume 447, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnico-qualitativa relativa alla procedura aperta per la realizzazione "chiavi in mano" di n. 1 sala operatoria ibrida multidisciplinare per l'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Stefania Bearzi quale supplente della Dott.ssa Francesca Vignandel.

La Commissione Giudicatrice, nella seduta precedente, aveva incaricato il segretario verbalizzante di richiedere agli operatori economici, tramite la piattaforma eAppaltiFVG, la visione delle apparecchiature proposte al fine di organizzare la prova pratica. Nella richiesta inviata in data 25 novembre 2022 veniva indicato per lo svolgimento della stessa il periodo che va dal 9 gennaio al 3 febbraio 2023 (ad esclusione della settimana 23-29 gennaio 2023).

In data odierna la Commissione Giudicatrice prende atto, quindi, delle risposte pervenute dagli operatori economici alla richiesta di visione della prova pratica loro inviata in data 25 novembre 2022 tramite la messaggistica disponibile sulla piattaforma eAppalti FVG, e nello specifico che:

- la ditta Siemens Healthcare S.r.l., con comunicazione dd. 01.12.2022, ha indicato, per lo svolgimento della prova pratica, il periodo tra l'1 e il 3 febbraio 2023, proponendo come siti identificati a tal fine l'Azienda Ospedale-Università di Padova, l'ASST degli Spedali Civili di Brescia e l'Ospedale San Raffaele di Milano;

- la ditta GE Medical Systems Italia S.p.a., con comunicazione dd. 05.12.2022, ha indicato, per lo svolgimento della prova pratica, le date dell'1 e 2 febbraio 2023, proponendo come sito identificato a tal fine il Galway University Hospital, Irlanda;

- la ditta Philips Spa, con comunicazione dd. 14.12.2022, ha indicato, per lo svolgimento della prova pratica, le giornate del 31 gennaio 2023 e l'1, 2, 3 febbraio 2023, proponendo come sito identificato a tal fine l'Ospedale di Dordrecht in Olanda, dando atto del ritardo nella risposta a causa di un malfunzionamento di sistema, non dipendente dalla volontà dell'operatore economico, né imputabile ad ASUGI.

La Commissione Giudicatrice prende atto positivamente delle risposte pervenute dagli operatori economici, rilevando altresì che, comunque, tutte le date proposte dalle ditte coincidono con il periodo di visione indicato loro per lo svolgimento della prova pratica.

La Commissione si riserva, quindi, di comunicare agli operatori economici le date e le sedi scelte per la prova pratica tramite la messaggistica della piattaforma eAppalti FVG.

La Commissione procede, quindi, con l'analisi della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici, e decide di avvalersi della consulenza del personale della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per la valutazione della parte edile impiantistica della documentazione.

Viene quindi disposto di consegnare in un secondo momento alla predetta Struttura le relazioni Tecnico-Illustrative del progetto, di cui al doc. 9, art. 15, del Disciplinare di Gara.

La Commissione Giudicatrice individua la data del 16.01.2023 come termine per la raccolta di eventuali richieste di chiarimento da trasmettere successivamente agli operatori economici. Alle ore 12.45 la seduta viene sospesa e viene riconvocata per il giorno 16.01.2023, ad ore 11.30.

Letto, approvato, sottoscritto.

Prof. Sandro Lepidi


Dott. Fabio Pozzi Mucelli

Dott.ssa Paola Bregant

Ing. Francesco Barbagli

Dott.ssa Elisa Colella

Dott.ssa Stefania Bearzi

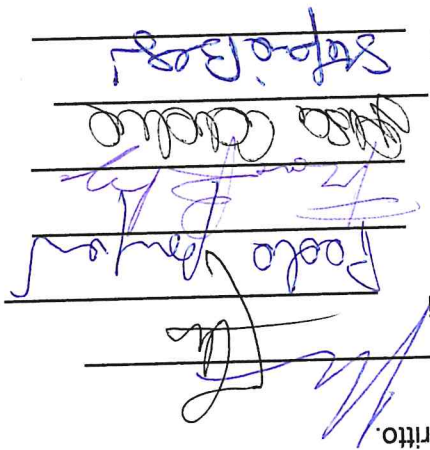

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA,

PER LA REALIZZAZIONE, "CHIAVI IN MANO",

DI N. 1 SALA OPERATORIA IBRIDA MULTIDISCIPLINARE

PER L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

CIG: 9349832D70

CUP: G49J2101566002

CUP: G92C22000350002

VERBALE N. 4 Commissione giudicatrice

L'anno duemilaventitre, il giorno 16 del mese di gennaio, alle ore 11.45, presso l'aula riunioni della S.C. Anestesia e Rianimazione TIPO in Trieste, Strada di Fiume, n. 447, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnico-qualitativa relativa alla procedura aperta per la realizzazione "chiavi in mano" di n. 1 sala operatoria ibrida multidisciplinare per l'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Francesca Vignandel. E' presente anche la nominata supplente Dott.ssa Stefania Bearzi.

A seguito della precedente seduta dd. 15 dicembre 2022, su mandato della Commissione, il segretario verbalizzante ha inviato, tramite la messaggistica disponibile su piattaforma e-AppaltiFVG, apposita comunicazione alle ditte per informarle delle date indicative scelte per lo svolgimento della prova pratica, specificando che sarebbero state oggetto di conferma previo riscontro positivo dell'agenzia viaggi convenzionata con ASUGI.

Ai sensi di quanto sopra, in data odierna si dà atto che, viste le disponibilità indicate dalle ditte interessate, al fine di contenere le tempistiche, in data 21.12.2022, tramite l'apposita messaggistica della piattaforma e-AppaltiFVG, sono state comunicate agli operatori economici le seguenti date indicative per lo svolgimento della prova pratica:

- PHILIPS S.p.a: nella giornata del 31 gennaio 2023, presso l'Ospedale di Dordrecht (Olanda);
- GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.a: nella giornata del 1 febbraio 2023, presso il Galway University Hospital (Irlanda);
- SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.: nella giornata del 3 febbraio 2023, presso l'Azienda Ospedale-Università di Padova (Italia).



In data odierna la Commissione, dispone che il segretario verbalizzante confermi alle ditte interessate le date sopra citate per lo svolgimento della prova pratica.


Rilevato che non vi sono richieste di chiarimenti da inviare alle ditte, la Commissione prosegue con la valutazione nel merito della documentazione tecnica.


La Commissione decide di proseguire la valutazione nel merito della documentazione tecnica, sempre in seduta riservata, a seguito dell'esperimento delle prove pratiche.


La Commissione prende atto della indisponibilità sopravvenuta, per motivi personali, rappresentata dal Dott. Fabio Pozzi Mucelli - Dirigente Medico presso la S.C. Radiologia Diagnostica ed Interventistica, per il quale si richiede all'Amministrazione di procedere alla individuazione e relativa nomina di un sostituto.

La seduta riservata si conclude alle ore 12.30.


Letto, approvato, sottoscritto.



Prof. Sandro Lepidi



Dott. Fabio Pozzi Mucelli


Dott.ssa Paola Bregant


Ing. Francesco Barbagli


Dott.ssa Elisa Colella


Dott.ssa Francesca Vignandel

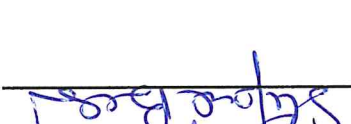
Dott.ssa Stefania Bearzi

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA,

PER LA REALIZZAZIONE, "CHIAVI IN MANO",

DI N. 1 SALA OPERATORIA IBRIDA MULTIDISCIPLINARE

PER L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

CIG: 9349832D70

CUP: G49J21015660002

CUP: G92C22000350002

VERBALE N. 5 Commissione giudicatrice

L'anno duemilaventitre, il giorno 16 del mese di febbraio, alle ore 11.30, presso l'aula riunioni della S.C. Anestesia e Rianimazione TIPO in Trieste, Strada di Fiume, n. 447, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnico-operativa relativa alla procedura aperta per la realizzazione "chiavi in mano" di n. 1 sala operatoria ibrida multidisciplinare per l'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Francesca Vignandel. E' presente anche la nominata supplente Dott.ssa Stefania Bearzi.

La Commissione Giudicatrice nella seduta dd. 16 gennaio 2023, aveva proseguito la valutazione della documentazione tecnica di cui all'art 15 del Disciplinare di Gara, aveva preso atto della temporanea indisponibilità sopravvenuta del Dott. Pozzi Mucelli, per sopporre alla quale con Decreto del Direttore Generale n. 61 dd. 27.01.2023 è stato nominato quale sostituto il Dott. Manuel Gianvalerio Belgiano, e infine aveva incaricato il segretario verbalizzante di confermare, tramite apposita messaggio, le date per l'espletamento delle prove pratiche.

Si prende atto che con comunicazione dd. 23.01.2023 le ditte hanno ricevuto tramite messaggio eAppalti FVG conferma delle medesime date previamente comunicate per lo svolgimento della prova pratica, con espressa indicazione che le spese necessarie allo svolgimento delle prove pratiche, totalmente a carico delle ditte, come previsto al punto 13 del Capitolato Tecnico, saranno calcolate e comunicate a consuntivo.

In data odierna la Commissione, presente anche il Dott. Belgiano, che in qualità di sostituto del Dott. Pozzi Mucelli ha preso parte allo svolgimento delle prove pratiche, procede a relazionare la visita effettuata nella giornata del 31 gennaio 2023 presso l'Ospedale di Dordrecht (Olanda), la visita effettuata in data 1 febbraio 2023 presso il Galway University Hospital (Irlanda) e la visita



Handwritten signatures in blue ink at the top of the page.

effettuata in data 3 febbraio presso l'Azienda Ospedale-Università di Padova (Italia), relativamente alle apparecchiature offerte dai seguenti operatori economici:

- Costituendo RTI PHILIPS S.p.A. C.F./P.IVA 00856750153 (Capogruppo Mandataria) e C.R.S. IMPIANTI S.r.l. C.F./P.IVA 03398270169 (Mandante);
- Costituendo RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. C.F. 93027710016 P. I.V.A. 03663500969 (Capogruppo Mandataria) e MORVIDUCCI S.r.l. C.F./P.IVA 05690581003 (Mandante);
- Costituendo RTI SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. C.F. 04785851009 P.IVA 12268050155 (Capogruppo Mandataria) e S.M. SERVICE S.r.l. C.F./P.IVA 03502110277.

Preso atto della relazione, la Commissione procede con la valutazione delle prove pratiche e rileva che la prova pratica di ciascuna delle ditte interessate supera la soglia di sufficienza prevista dall'art. 17.1 del Disciplinare di Gara.

Le risultanze della prova pratica sono contenute nei verbali conservati agli atti della scrivente Amministrazione.

La seduta riservata si conclude alle ore 13.00.

Letto, approvato, sottoscritto.

Prof. Sandro Lepidi

Dott. Manuel Gianvalerio/Belgrano

Dott. Fabio Pozzi Mucelli

Dott.ssa Paola Bregant









Ing. Francesco Barbagli

Dott.ssa Elisa Colella

Dott.ssa Francesca Vignandel

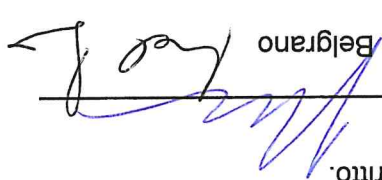Dott.ssa Stefania Bearzi

(in quanto sostituto del Dott. Pozzi Mucelli)

AA 88

Dott.ssa Elisa Colella
 Ing. Francesco Barbagli
 Dott.ssa Paola Bregant
 Dott. Fabio Pozzi Mucelli
 Prof. Sandro Lepidi

Letto, approvato, sottoscritto.

Alle ore 13.00 la Commissione dichiara conclusi i lavori.

La Commissione decide di procedere con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica nella prossima seduta, fissata per il giorno 02.03.2023 alle ore 8.30.

In data odierna la Commissione prosegue e conclude l'analisi dei documenti di cui all'art. 15 del Disciplinare di Gara.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Francesca Vignandel. E' presente anche la nominata supplente Dott.ssa Stefania Bearzi.

L'anno duemilaventitre, il giorno 23 del mese di febbraio, alle ore 11.30, presso l'aula riunioni della S.C. Anestesia e Rianimazione TIPO in Trieste, Strada di Fiume, n. 447, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnico-qualitativa relativa alla procedura aperta per la realizzazione "chiavi in mano" di n. 1 sala operatoria ibrida multidisciplinare per l'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina.

VERBALE N. 6 Commissione giudicatrice



CUP: G92C22000350002

CUP: G49J21015660002

CIG: 9349832D70

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA,
 PER LA REALIZZAZIONE, "CHIAVI IN MANO",
 DI N. 1 SALA OPERATORIA IBRIDA MULTIDISCIPLINARE
 PER L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA**



Dott.ssa Francesca Vignandel

Dott.ssa Stefania Bearzi


Handwritten signatures in blue ink at the top of the page.

- il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella sottostante:

TOTALE	100
Offerta Economica	30
Offerta Tecnica	70
PUNTEGGIO MASSIMO	

- la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

A memoria del Disciplinare di gara, il Presidente della Commissione Giudicatrice ricorda che: Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Francesca Vignandel.

L'anno duemilaventitre, il giorno 2 del mese di marzo, alle ore 8.30, presso l'aula riunioni della S.C. Anestesia e Rianimazione TIPO in Trieste, Strada di Fiume, n. 447, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnico-qualitativa relativa alla procedura aperta per la realizzazione "chiavi in mano" di n. 1 sala operatoria ibrida multidisciplinare per l'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina.

VERBALE N. 7 Commissione giudicatrice

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA,
PER LA REALIZZAZIONE, "CHIAVI IN MANO",
DI N. 1 SALA OPERATORIA IBRIDA MULTIDISCIPLINARE
PER L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA**

CIG: 9349832D70
CUP: G49J21015660002
CUP: G92C22000350002



Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

PUNTEGGIO CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE	25,20	26,06	28,43
PUNTEGGIO SERVIZI	3,87	1,94	2,15
PUNTEGGIO PROVA PRATICA	23,27	26,50	32,32
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. e MORVIDUCCI S.r.l.	RTI PHILIPS S.p.A. e C.R.S. IMPIANTI S.r.l.	RTI SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. e S.M. SERVICE S.r.l.	

si procederà alla riparametrizzazione dei punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle proposte oggetto di esame da parte della Commissione dovesse aver conseguito, a seguito dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di punti 70.

Nella seduta odierna la Commissione Giudicatrice procede quindi con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, come da allegato di dettaglio, facente parte integrante del presente verbale.

I punteggi relativi all'offerta tecnica risultano, in sintesi, conseguentemente i seguenti:

COEFFICIENTE	VOCE DI GIUDIZIO
1,0	Ottimo
0,9	Distinto
0,8	Buono
0,7	Più che Adeguato
0,5	Adeguato
0,4	Parzialmente Adeguato
0,2	Scarsamente Adeguato
0	Inadeguato

a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale sarà attribuito discrezionalmente da parte della Commissione Giudicatrice un coefficiente sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE	
PUNTEGGI TABELLARI - (T)	Punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
PUNTEGGI DISCREZIONALI - (D)	Punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

PUNTEGGIO TOTALE	52,34	54,50	62,90
OFFERTA TECNICA	58,25	60,65	70,00
PUNTEGGIO DEFINITIVO			
RIPARAMETRATO			

La Commissione Giudicatrice rileva che la valutazione della qualità complessiva di tutte e tre le ditte supera la soglia minima di punti prevista all'art. 17.1 del Disciplinare di Gara.

Per le risultanze ivi riportate, gli operatori economici:

- Costituendo RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. C.F. 93027710016 P. I.V.A. 03663500969 (Capogruppo Mandataria) e MORVIDUCCI S.r.l. C.F./P.IVA 05690581003 (Mandante);
- Costituendo RTI PHILIPS S.p.A. C.F./P.IVA 00856750153 (Capogruppo Mandataria) e C.R.S. IMPIANTI S.r.l. C.F./P.IVA 03398270169 (Mandante);
- Costituendo RTI SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. C.F. 04785851009 P.IVA 12268050155 (Capogruppo Mandataria) e S.M. SERVICE S.r.l. C.F./P.IVA 03502110277.

vengono ammessi all'ultima fase della procedura di gara che si terrà in seduta pubblica con la lettura dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica e l'apertura della busta economica sulla piattaforma e-Appalti FVG.

Alle ore 10.00 la Commissione dichiara conclusi i lavori.

Letto, approvato, sottoscritto.

Prof. Sandro Lepidi

Dott. Fabio Pozzi Mucelli

Dott.ssa Paola Bregant

Ing. Francesco Barbagli

Dott.ssa Elisa Colella

Dott.ssa Francesca Vignandel

- Allegato: All_griglia_valutazione

GE		PHILIPS		SIEMENS	
Caratteristiche tecniche	25,20	Caratteristiche tecniche	26,06	Caratteristiche tecniche	28,43
Servizi	3,87	Servizi	1,94	Servizi	2,15
Prova pratica	23,27	Prova pratica	26,50	Prova pratica	32,32
TOT	52,34	TOT	54,50	TOT	62,90
TOT riparametrato	58,25	TOT riparametrato	60,65	TOT riparametrato	70,00

CRITERI DI VALUTAZIONE		Punti Attribuibili 30,15
CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE		
ANGIOGRAFO		
Max: 12,92 Punti		Criterio

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE		Punti	Criterio
Verranno valutati i requisiti tecnici dell'angiografo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la distanza tubo-detettore, il FOV/acquisito, maggior escursioni nelle rotazioni RAO/LAO e CRA/CAU, velocità di rotazione, altro.	4,31	Discrezionale	3,45 Distinto
acquisizioni 3D	4,31	Discrezionale	3,88 Ottimo
Il punteggio più elevato sarà assegnato alla migliore proposta in termini di: - maggiore escursione angolare; - tempi di acquisizione e ricostruzione delle immagini; - dimensioni dei voxel; - numero e dimensioni dei FOV disponibili.	4,31	Discrezionale	3,88 Ottimo
GENERATORE E TUBO RADIOGENO			
Verranno valutati i requisiti tecnici del generatore e del tubo radiogeno, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la potenza del generatore, le dimensioni del fuoco piccolo, il numero di macchie focali, altro	2,15	Discrezionale	2,15 Distinto
SISTEMA DI FORMAZIONE E GESTIONE DELL'IMMAGINE			
Verranno valutati i requisiti tecnici per la formazione e gestione dell'immagine quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: maggiore area attiva del detettore, dimensioni del pixel, efficienza quantica del rivelatore DQE (celi 52220-1), matrice attiva di acquisizione, altro	2,15	Discrezionale	2,15 ottimo

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]

SISTEMI DI RIDUZIONE DELLA DOSE AL PAZIENTE E AGLI OPERATORI		Max. 4,31 Punti	Criterio	3,23 ottimo	3,23 ottimo	3,23
<p>sistemi di riduzione della dose</p> <p>Sarà valutata la presenza e l'efficacia dei sistemi software e/o hardware atti a ridurre, significativamente, la dose al paziente e/o all'operatore.</p>		3,23	Discrezionale	ottimo	ottimo	ottimo
<p>visualizzazione della mappa di dose cutanea - Visualizzazione con codifica colorimetrica, o con toni di grigio, della dose cutanea su rappresentazione grafica del paziente durante l'intera procedura angiografica.</p> <p>Se assente - $P_A = 0$ - Se presente - $P_A = P_{Max}$</p> <p>(P_A = Punteggio Attribuito; P_{Max} = Punteggio Massimo Previsto)</p>		1,08	Tabellare	presente	1,08 presente	1,08 presente
<p>INTEGRAZIONE SISTEMI CON SISTEMI INFORMATIVI</p> <p>Il punteggio massimo previsto sarà assegnato ai sistemi offerti con caratteristiche migliorative rispetto a quanto previsto negli allegati "Specifiche IT ASUGI" e "allegato SIO-PACS".</p>		2,15	Discrezionale	Distinto	1,94 Distinto	1,72 Buono
<p>PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA SALA IBRIDA</p> <p>Nell'ambito del progetto di realizzazione della Sala Ibrida saranno valutate:</p> <ul style="list-style-type: none"> le proposte in grado di sfruttare, al meglio, gli spazi disponibili in relazione alla destinazione d'uso indicata e alle esigenze degli operatori di una sala ibrida multidisciplinare. Verranno valutati - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il posizionamento dei pensili e delle lampade scialitiche in relazione all'angiografo, il flusso di ingresso/uscita dei pazienti, l'ergonomia del personale di sala sul campo operatorio e di supporto, l'intralcio dell'angiografo in posizione di parcheggio, altro... 		8,62	Discrezionale	buono	6,90 buono	6,90 ottimo
<p>Il progetto proposto da GE garantisce un buon ingresso del paziente dovendo spostare solo il pensile con il large monitor e adeguata posizione di parcheggio dell'apparecchiatura. La testa del paziente è sul lato opposto rispetto all'ingresso; la soluzione proposta comporta il posizionamento del tavolo sterile molto vicino alla porta d'ingresso e comunque fuori dal flusso laminare. Sono stati offerti due large monitor da 58", uno con doppio monitor di backup da 19" e nuove lampade scialitiche; verranno riutilizzati i pensili anestesista e chirurgo. Il piano operatorio in fibra di carbonio offerto è radiotrasparente su tutta la lunghezza: 1850 mm. Si prende atto della proposta dell'armadio passa ferri.</p>		8,62	Discrezionale	buono	6,90 buono	6,90 ottimo
<p>Il progetto proposto da PHILIPS prevede il pensile anestesista sul percorso ingresso paziente, che implica la necessità di spostare il pensile e l'apparecchio di anestesia o ai piedi del tavolo o sulla parete. La posizione di parcheggio dell'apparecchiatura è adeguata, mentre quella del pensile anestesista non permette di raggiungere la testa del paziente in interventi con paziente ruotato. Sono stati offerti un large monitor da 58" con doppio monitor di backup da 27" e due monitor da 27" e nuove lampade scialitiche; verranno riutilizzati i pensili anestesista e chirurgo. Il piano operatorio in fibra di carbonio offerto è radiotrasparente su tutta la lunghezza: 1650 mm.</p>		8,62	Discrezionale	buono	6,90 buono	6,90 ottimo
<p>Il progetto proposto da SIEMENS prevede il pensile anestesista più centrato rispetto al tavolo e decentrato rispetto alla porta d'ingresso permettendo l'ingresso del paziente senza troppo disturbo. La posizione del pensile anestesista permette di utilizzare lo stesso pensile anche con paziente ruotato. Appare adeguata la posizione di parcheggio dell'apparecchiatura. Si evidenziano importanti spazi di manovra anche grazie alla colonna del tavolo operatorio ruotabile. Sono stati offerti un large monitor da 55" e due monitor da 24" e nuove lampade scialitiche; verranno riutilizzati i pensili anestesista e chirurgo. Il piano operatorio in fibra di carbonio offerto è radiotrasparente su tutta la lunghezza: 1850 mm</p>		8,62	Discrezionale	buono	6,90 buono	6,90 ottimo

Puntuali		Adeguato		Parzialmente adeguato		0,86	
<p>La qualità dei materiali e delle finiture è descritta in modo adeguato per la parte elettrica essendo indicate la normativa di riferimento e le caratteristiche tecniche. Per la parte meccanica ed edile vengono accennate le caratteristiche dei nuovi materiali senza far riferimento alla normativa di riferimento ed alle caratteristiche degli stessi. Non risultano esserci elementi per valutare la necessità di interventi strutturali a pavimento considerato il peso dell'apparecchiatura. Le soluzioni impiantistiche migliorative proposte sono da considerarsi complessivamente di impatto minimale rispetto ai requisiti minimi (interessante il sistema DALI per la creazione di scenari di illuminazione mentre si ritiene poco significativa l'installazione di fan coil a supporto delle UTA nella sala ibrida, sebbene non presentata come proposta migliorativa).</p>		<p>La qualità dei materiali e delle finiture è descritta in modo adeguato per la parte elettrica essendo indicate la normativa di riferimento e le caratteristiche tecniche (Disciplinare Tecnico Descrittivo). Per la parte meccanica ed edile le caratteristiche dei nuovi materiali sono desumibili dal computo metrico estimativo. Gli interventi strutturali ed i materiali utilizzati sono ben indicati negli elaborati grafici strutturali. Non emergono proposte migliorative rispetto ai requisiti minimi richiesti all'Art. 8 del Capitolato Speciale.</p>		<p>La qualità dei materiali e delle finiture è descritta in modo sommario per tutte le parti nel Disciplinare Tecnico Descrittivo. Gli interventi strutturali ed i materiali utilizzati sono ben indicati nell'elaborato Plans di installazione nonostante si demandi ad ulteriori prove di carico la soluzione proposta. Non emergono proposte migliorative rispetto ai requisiti minimi richiesti all'Art. 8 del Capitolato Speciale.</p>		0,86	
SERVIZI							
Punti Attribuibili 7,53							
FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO							
Verrà valutata la completezza ed esaustività dei corsi previsti per il personale sanitario.		Max 2,15 Punt	Criterio				
		2,15	Discrezionale			2,15	
GARANZIA							
Verrà attribuito un punteggio per ogni ulteriore anno di garanzia offerto rispetto al minimo richiesto di 2 anni		Max 3,23 Punt	Criterio				
Minimo Richiesto (2 anni)		0 Punt					
AGGIORNAMENTO SOFTWARE							
Sarà considerata la disponibilità a fornire, in maniera incondizionata e senza oneri aggiuntivi, tutti gli aggiornamenti (minor e major release) del software di sistema e degli applicativi che si dovessero rendere disponibili nel periodo considerato.		Max 2,15 Punt	Criterio				
Tutti gli aggiornamenti per 3 anni dall'installazione:		2,15 punti	Tabellare			0,00	
Tutti gli aggiornamenti per 2 anni dall'installazione:		1,62 punti					
Nessun aggiornamento:		0,0 punti					
PROVA PRATICA							
Punti Attribuibili 32,32							
Si, nel periodo contrattuale ma limitato a sole due release. Pertanto l'offerta tecnica non soddisfa i criteri indicati in tabella		2,15	Tabellare			0,00	
Solo aggiornamenti di sicurezza		0,00				0,00	

QUALITÀ IMMAGINE		Max 4,31 Punt	Criterio	3,88	Distinto	3,88	Ottimo	4,31
Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta tecnologica in grado di garantire la migliore qualità immagine percepita, valutando parametri quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il contrasto, il rumore e la presenza di artefatti, nelle varie condizioni di utilizzo clinico.		4,31	Discrezionale	Sulla base della prova pratica effettuata, per le caratteristiche del paziente e le modalità di lavoro utilizzate sull'apparecchiatura, la qualità dell'immagine percepita è stata ritenuta di elevata qualità	Ottimo	Sulla base della prova pratica effettuata, per le caratteristiche del paziente e le modalità di lavoro utilizzate sull'apparecchiatura, la qualità dell'immagine percepita è stata ritenuta di elevata qualità	Ottimo	Sulla base della prova pratica effettuata, per le caratteristiche del paziente e le modalità di lavoro utilizzate sull'apparecchiatura, la qualità dell'immagine percepita è stata ritenuta di ottima qualità
SOFTWARE SPECIALISTICI		Max 6,47 Punt	Criterio	6,47	Ottimo	6,47	Ottimo	6,47
Il punteggio massimo sarà attribuito alle soluzioni software specialistiche - comprese in offerta - in grado di migliorare l'utilizzo/la qualità delle immagini/le procedure/l'usabilità e l'ergonomia nell'uso dell'apparecchiature, in base alla destinazione d'uso prevista.		6,47	Discrezionale	I software offerti risultano completi per la destinazione d'uso prevista	Ottimo	I software offerti risultano completi per la destinazione d'uso prevista	Ottimo	I software offerti risultano completi per la destinazione d'uso prevista
ANGIOGRAFO		Max 10,77 Punt	Criterio	7,54	Più che Adeguato	7,54	Buono	10,77
Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica in grado di garantire la maggiore flessibilità, qualità e potenzialità dell'angiografo in base alla destinazione d'uso prevista.		10,77	Discrezionale	L'apparecchiatura proposta da GE, presenta un interessante soluzioni con arco disassato rispetto al piano del paziente, in grado di disturbare meno l'anestesista e di garantire movimentazioni dell'arco dalla pozione testa del paziente fino a 126 cm. La soluzione mobile su ruote, sebbene garantisca massima flessibilità, presenta movimentazioni inferiori rispetto alle altre soluzioni proposte	Più che Adeguato	L'apparecchiatura proposta di Philips, con installazione a soffitto, garantisce estese movimentazioni dell'arco rispetto al tavolo operatorio, con imponenti movimentazioni, in grado di raggiungere tutti i distretti d'interesse.	Buono	Considerata la destinazione d'uso prevista per la sala ibrida e la presenza di un tavolo operatorio che obbliga a ruotare il paziente per interventi agli arti inferiori, l'apparecchiatura SIEMENS, seppur fissata al suolo, non comporta limiti nell'utilizzo dell'angiografo. La concezione innovativa del sistema esalta invece i vantaggi della soluzione proposta in termini di movimentazioni: ingombro ridotto nell'area operatoria, versatilità dell'accesso al paziente da parte degli operatori
ERGONOMIA DEL SISTEMA		Max 10,77 Punt	Criterio	5,39	Adeguato	5,39	Più che adeguato	10,77
Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta tecnologica che presenterà la migliore ergonomia complessiva del sistema, valutata come di seguito specificato:		10,77	Discrezionale	L'apparecchiatura proposta da GE, con arco disassato rispetto al paziente, risulta versatile e innovativa e in grado di garantire una buona ergonomia per l'anestesista e per il primo chirurgo, viceversa risulta meno ergonomica per il personale che deve posizionarsi dal lato dell'arco. Il complesso arco-detettore-tubo, risulta piuttosto ingombrante. Il sistema di controllo dell'angiografo e il doppio large monitor risultano di facile utilizzo. Il software appare intuitivo. Le funzioni avanzate del software durante la procedura sono state giudicate adeguate.	Adeguato	L'apparecchiatura proposta da PHILIPS, con installazione a soffitto, garantisce ampi movimenti ma con un certo ingombro dato dalla struttura stessa a soffitto dell'apparecchiatura. Le console di controllo si sono dimostrate di facile gestione per le movimentazioni dell'angiografo. Da quanto è stato visionato, il software è risultato adeguato.	Più che adeguato	L'apparecchiatura SIEMENS permette una maggiore libertà di movimento da parte del personale di sala, anche grazie al tavolo ruotabile. L'ingombro sul campo operatorio è ridotto, il sistema di controllo risulta versatile e il software intuitivo. Il supporto garantito durante la procedura da parte della funzione FUSION è risultato ottimale. L'insieme arco, detettore e tubo garantisce un ingombro molto contenuto

(Handwritten signatures and initials)

Handwritten signatures in blue ink at the top of the page.

28,43	26,06	25,20	PUNTEGGIO CARATTERISTICHE TECNICO- CLINICHE
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. e S.M. SERVICE S.r.l.	RTI PHILIPS S.p.A. e C.R.S. IMPIANTI S.r.l.	RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. e MORVIDUCCI S.r.l.	

L'anno duemilaventitre, il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 14.30, presso la sala riunioni al 1° piano della palazzina della Direzione Infermieristica, presso l'Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume, n. 447, Trieste, si è riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnico-qualitativa relativa alla procedura aperta per la realizzazione "chiavi in mano" di n. 1 sala operatoria ibrida multidisciplinare per l'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina.

Partecipa alla seduta il RUP e Presidente del Seggio di Gara, dott. Giovanni Maria Coloni, Direttore della S.C. Proveditorato e Economato.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Francesca Vignandel. E' presente anche la nominata supplente Dott.ssa Stefania Bearzi.

Si dà atto del collegamento da remoto dei rappresentanti delle ditte GE MEDICAL SYSTEM SRL, PHILIPS SPA e SIEMENS HEALTHCARE SRL, delegati ad assistere alla seduta, debitamente identificati tramite documentazione agli atti.

Nella seduta odierina il RUP, dott. Giovanni Maria Coloni, dà lettura del verbale n. 7 limitatamente alla parte dei punteggi relativi all'offerta tecnica, come di seguito sintetizzati e riparimetrati:

VERBALE N.8 Commissione giudicatrice

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA,
PER LA REALIZZAZIONE, "CHIAVI IN MANO",
DI N. 1 SALA OPERATORIA IBRIDA MULTIDISCIPLINARE
PER L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA**

CIG: 9349832D70

CUP: G49J21015660002

CUP: G92C22000350002



PUNTEGGIO DEFINITIVO RIPARAMETRATO	58,25	60,65	70,00
PUNTEGGIO PROVA PRATICA	3,87	1,94	2,15
PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA	52,34	54,50	62,90
PUNTEGGIO DEFINITIVO RIPARAMETRATO	58,25	60,65	70,00

Il segretario verbalizzante provvede, quindi, all'inserimento manuale dei punteggi tecnici complessivi riparametrati all'interno della piattaforma eAppaltiFVG, come risultanti dal verbale n. 7 della Commissione Giudicatrice e procede al congelamento della busta tecnica.

Si procede, dunque, all'apertura delle buste economiche e al download massivo della documentazione presente nella busta economica presentata da ciascun operatore economico, nel seguente ordine:

- Costituendo RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. C.F. 93027710016 P. I.V.A. 03663500969 (Capogruppo Mandataria) e MORVIDUCCI S.r.l. C.F./P.IVA 05690581003 (Mandante);
- Costituendo RTI PHILIPS S.p.A. C.F./P.IVA 00856750153 (Capogruppo Mandataria) e C.R.S. IMPIANTI S.r.l. C.F./P.IVA 03398270169 (Mandante);
- Costituendo RTI SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. C.F. 04785851009 P.IVA 12268050155 (Capogruppo Mandataria) e S.M. SERVICE S.r.l. C.F./P.IVA 03502110277.

Si procede, quindi, alla verifica formale della corrispondenza della documentazione caricata dagli operatori economici sopra indicati rispetto a quanto previsto nel Disciplinare di Gara, all'art. 16. Verificata la completezza della documentazione contenuta nella busta economica, si dà lettura delle offerte economiche presentate per la fornitura in oggetto:

OPERATORE ECONOMICO	PREZZO OFFERTO (IVA ESCLUSA)
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. e MORVIDUCCI S.r.l.	1.236.972,71
RTI PHILIPS S.p.A. e C.R.S. IMPIANTI S.r.l.	1.401.108,00
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. e S.M. SERVICE S.r.l.	1.348.518,00

Handwritten signatures in blue ink are present above the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

La Commissione procederà in seduta riservata alla verifica delle offerte economiche presentate.

La seduta si conclude alle ore 15.30.

Letto, approvato, sottoscritto.

Dott. Giovanni Maria Coloni

Prof. Sandro Lepidi

Dott. Fabio Pozzi Mucelli









Dott.ssa Paola Bregant

Ing. Francesco Barbagli

Dott.ssa Elisa Colella

Dott.ssa Francesca Vignandel

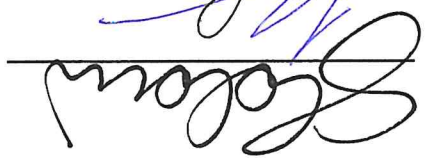Dott.ssa Stefania Bearzi

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA,
 PER LA REALIZZAZIONE, "CHIAVI IN MANO",
 DI N. 1 SALA OPERATORIA IBRIDA MULTIDISCIPLINARE
 PER L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA**

CIG: 9349832D70

CUP: G49J2101566002

CUP: G92C22000350002

VERBALE N. 9 Commissione giudicatrice


L'anno duemilaventitre, il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 15.35, presso la sala riunioni al 1° piano della palazzina della Direzione Infermieristica, presso l'Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume, n. 447, Trieste, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnico-qualitativa relativa alla procedura aperta per la realizzazione "chiavi in mano" di n. 1 sala operatoria ibrida multidisciplinare per l'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Francesca Vignandel. E' presente anche la nominata supplente Dott.ssa Stefania Bearzi.

Nella seduta pubblica di data odierna si dava lettura dei punteggi relativi all'offerta tecnica e si procedeva al congelamento delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici, con successiva apertura delle buste economiche.

Veniva effettuato il download massivo della documentazione caricata nelle buste economiche presentate dagli operatori economici partecipanti:

- Costituendo RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. C.F. 93027710016 P. I.V.A. 03663500969 (Capogruppo Mandataria) e MORVIDUCCI S.r.l. C.F./P.IVA 05690581003 (Mandante);
- Costituendo RTI PHILIPS S.p.A. C.F./P.IVA 00856750153 (Capogruppo Mandataria) e C.R.S. IMPIANTI S.r.l. C.F./P.IVA 03398270169 (Mandante);
- Costituendo RTI SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. C.F. 04785851009 P.IVA 12268050155 (Capogruppo Mandataria) e S.M. SERVICE S.r.l. C.F./P.IVA 03502110277.

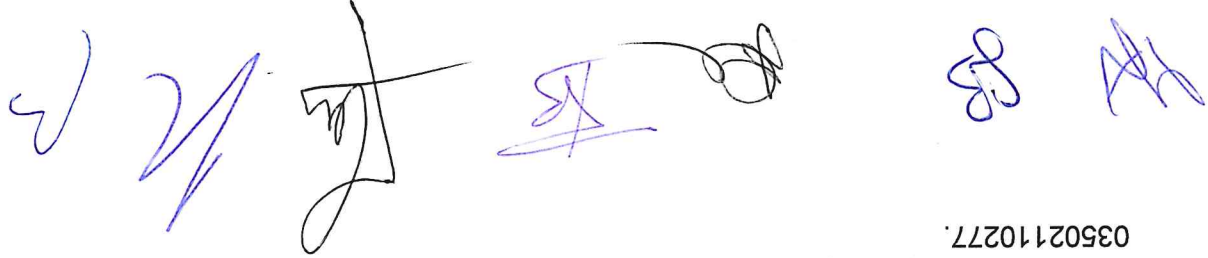

Nella seduta riservata odierna, la Commissione verifica con esito positivo la rispondenza del contenuto dei documenti presentati dai tre operatori economici rispetto a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara al punto 16.

La Commissione procede, infine, all'attribuzione dei seguenti punteggi relativi alle offerte economiche, secondo quanto previsto dall'articolo 17.3 del Disciplinare di Gara:

OPERATORE ECONOMICO	PREZZO OFFERTO (IVA ESCLUSA)	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti)
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. e MORVIDUCCI S.r.l.	1.236.972,71	30,00
RTI PHILIPS S.p.A. e C.R.S. IMPIANTI S.r.l.	1.401.108,00	17,61
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. e S.M. SERVICE S.r.l.	1.348.518,00	22,73

La Commissione riaggiornerà i lavori alla successiva seduta pubblica di data 21/03/2023 alle ore 8.45, nella quale verrà data lettura dei punteggi assegnati alle offerte economiche e comunicata la graduatoria finale.

Il Presidente della Commissione incarica il segretario verbalizzante di notificare gli operatori economici della data della prossima seduta pubblica tramite apposita messaggioistica del portale eAppaltiFVG.

La seduta si conclude alle ore 16.00 circa.

Letto, approvato, sottoscritto.

Prof. Sandro Lepidi

Dott. Fabio Pozzi Mucelli

Dott.ssa Paola Bregant

Ing. Francesco Barbagli

Dott.ssa Elisa Colella

Dott.ssa Francesca Vignandei

85

(Handwritten signatures and names: Sandro Lepidi, Fabio Pozzi Mucelli, Paola Bregant, Francesco Barbagli, Elisa Colella, Francesca Vignandei)

Dott.ssa Stefania Bearzi

Stefania Bearzi



**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA,
PER LA REALIZZAZIONE, "CHIAVI IN MANO",
DI N. 1 SALA OPERATORIA IBRIDA MULTIDISCIPLINARE
PER L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA**

CIG: 9349832D70

CUP: G49J21015660002

CUP: G92C22000350002

VERBALE N. 10 Commissione giudicatrice

L'anno duemilaventitre, il giorno 22 del mese di marzo, alle ore 8,45, presso la sala riunioni al 1° piano della palazzina della Direzione Infermieristica, presso l'Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume, n. 447, Trieste, si è riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnico-qualitativa relativa alla procedura aperta per la realizzazione "chiavi in mano" di n. 1 sala operatoria ibrida multidisciplinare per l'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina.

Partecipa alla seduta il RUP e Presidente del Seggio di Gara, dott. Giovanni Maria Coloni, Direttore della S.C. Provveditorato e Economato.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Francesca Vignandel. E' presente anche la nominata supplente Dott.ssa Stefania Bearzi.

Si dà atto del collegamento da remoto dei rappresentanti delle ditte GE MEDICAL SYSTEM SRL e SIEMENS HEALTHCARE SRL, delegati ad assistere alla seduta, debitamente identificati tramite documentazione agli atti.

Il RUP, dott. Giovanni Maria Coloni, dà atto che in seduta riservata la Commissione ha svolto le valutazioni rispetto alle offerte economiche presentate e le verifiche hanno dato esito positivo per tutti e tre gli operatori economici.

Si procede, dunque, a dare lettura dei punteggi assegnati alle offerte economiche, secondo quanto previsto dall'articolo 17.3 del Disciplinare di Gara:

OPERTAORE ECONOMICO	PREZZO OFFERTO (IVA ESCLUSA)	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti)
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. e MORVIDUCCI S.r.l.	1.236.972,71	30,00
RTI PHILIPS S.p.A. e C.R.S. IMPIANTI S.r.l.	1.401.108,00	17,61
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. e S.M. SERVICE S.r.l.	1.348.518,00	22,73

Il segretario verbalizzante inserisce manualmente il punteggio economico all'interno della piattaforma eAppaltiFVG in modo da procedere al congelamento della valutazione economica. Vengono quindi riepilogati i punteggi assegnati alla qualità e al prezzo relativamente alle tre offerte e calcolati i punteggi complessivi:

	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	FINALE PUNTEGGIO
RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. e MORVIDUCCI S.r.l.	30,00	58,25	88,25
RTI PHILIPS S.p.A. e C.R.S. IMPIANTI S.r.l.	17,61	60,65	78,26
RTI SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. e S.M. SERVICE S.r.l.	22,73	70,00	92,73

La Commissione pertanto attesta che l'offerta che ha conseguito il punteggio complessivo maggiore è quella presentata dall'operatore economico RTI SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. e S.M. SERVICE S.r.l.; il secondo operatore economico classificato risulta essere RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. e MORVIDUCCI S.r.l., e il terzo operatore classificato risulta essere RTI PHILIPS S.p.A. e C.R.S. IMPIANTI S.r.l.

Si dà atto che la piattaforma eAppaltiFVG segnala quale anomalia l'offerta della seconda classificata RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. e MORVIDUCCI S.r.l.; al riguardo il RUP rileva che l'anomalia emerge dal sistema in quanto esso tiene conto del punteggio tecnico

riparametrizzato.

L'amministrazione si riserva quindi ulteriori approfondimenti in esito ai quali si stabilirà eventualmente se procedere alla verifica di anomalia nei confronti della seconda classificata. Si dichiarano chiuse le operazioni di gara e si trasmettono all'ufficio competente tutti gli atti e i documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La seduta si conclude alle ore 9.01.

Letto, approvato, sottoscritto.

Dott. Giovanni Maria Coloni

Prof. Sandro Lepidi

Dott. Fabio Pozzi Mucelli







Dott.ssa Paola Bregant

Ing. Francesco Barbagli

Dott.ssa Elisa Colella

Dott.ssa Stefania Bearzi

Dott.ssa Francesca Vignandel

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 12/04/2023 15:57:21
IMPRONTA: AE6BD8537E1C929BF84D923D857D73BDA8959384B7071F8F1DB94C59B4CB501D
A8959384B7071F8F1DB94C59B4CB501D041282152D382563636C2395776B6DA1
041282152D382563636C2395776B6DA14D75B8F5E181FBB02B8719D7C7D6BDCC
4D75B8F5E181FBB02B8719D7C7D6BDCC72294E95750BC3679C4C61E6C947DB29

NOME: EUGENIO POSSAMAI
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L
DATA FIRMA: 12/04/2023 16:17:29
IMPRONTA: 9212911901944A20B9B89B866F76227CE1564A1321C10530A5C3C780510DD581
E1564A1321C10530A5C3C780510DD58188E78303F39C7E3E7E0740936FDB5AEE
88E78303F39C7E3E7E0740936FDB5AEEF257873B6B4BA4F83ED5BE3E4C2CD33B
F257873B6B4BA4F83ED5BE3E4C2CD33BE03D60E532A4AB41DC3D156377136410

NOME: DANIELE PITTIONI
CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B
DATA FIRMA: 13/04/2023 09:14:05
IMPRONTA: 4BEFAF6FD3C60EA4DE4232F2FF4537C73BB923782C2179F92611BFEF7F67B51E
3BB923782C2179F92611BFEF7F67B51E6437403557A783B00E3BA4FAC163A1BD
6437403557A783B00E3BA4FAC163A1BDAC5B8DCDBBCBFC4E9D4A56C0E8873512
AC5B8DCDBBCBFC4E9D4A56C0E887351239858F602531BF6974124C006AE9B9AA

NOME: FABIO SAMANI
CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I
DATA FIRMA: 13/04/2023 11:02:14
IMPRONTA: BB52132A2EC3EB4C61234907DF75F10E975296695DD3247EEE295EB3462DAD1
E975296695DD3247EEE295EB3462DAD1E9B3F9AA3E000A1BB0F208FD68F00805
E9B3F9AA3E000A1BB0F208FD68F008057E296073F6926B398658174B864CFC17
7E296073F6926B398658174B864CFC17A8F17C377C2AC057B3C4366C70A6FC96